

## 三氯卡班 (TCC)

### 仪器配置

LC1620 液相色谱仪 (含高压恒流泵一台, 配紫外检测器)

Rheodyne 7725i 手动进样阀

### 色谱条件

色谱柱: Venusil XBP C8 (4.6\*100mm)


流动相: 70/30/0.1 甲醇/水/高氯酸

检测波长: 275nm

流速: 1.0ml/min

进样量: 20ul

样品浓度: 0.05mg/ml

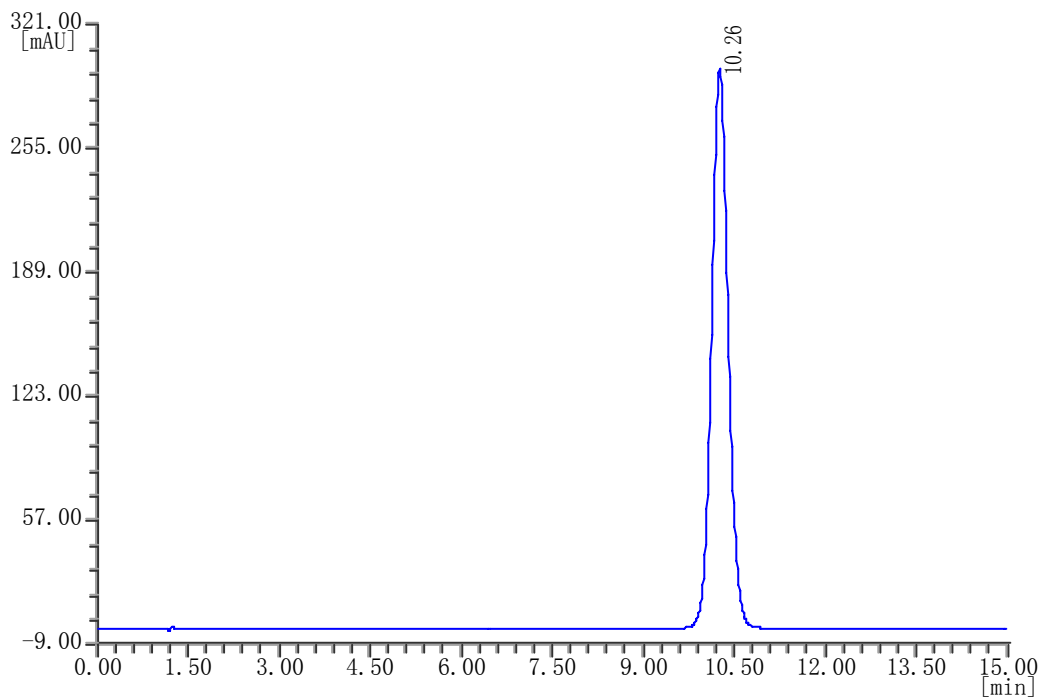

三氯卡班样品的色谱图